

Bernhard-Weiß-Str. 6  
10178 Berlin-Mitte

U + S Alexanderplatz

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ■ Bernhard-Weiß-Str. 6 ■ D-10178 Berlin

[www.berlin.de/sen/bjf](http://www.berlin.de/sen/bjf)

### nur per E-Mail

An die  
Schulleitungen aller Berliner Schulen

### nachrichtlich:

- zuständige Schulaufsicht
- Bildungsstadträtinnen und -stadträte

Geschäftszeichen I A 3

Bearbeitung Dirk Besch

Zimmer

Telefon

Zentrale ■ intern

E-Mail

Datum 17.03.2021

## Lieferung von Selbsttests an die Berliner Schulen

### hier: Kurzinformation zur Veränderung in der Lieferabfolge – Ausgabe der Selbsttests

Sehr geehrte Schulleiterin,  
sehr geehrter Schulleiter,

wie angekündigt, erfolgt seit dem 12.03.2021 die Auslieferung des Siemens-Selbsttests insbesondere an die OSZ und Schulen mit einer Sekundarstufe II. Schneller als erwartet und entgegen vorheriger Ankündigung findet nun parallel auch der Versand des Roche Covid-19 Antigen Selbsttests an die Schulen statt. Dieser Test ist ebenfalls als Selbsttest zugelassen und kann damit ebenso an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden. Der Test der Firma nal von minden, den Sie für die Schnelltestung der Kolleginnen und Kollegen bereits einsetzen, kann auch weiterhin als solcher verwendet werden.

### Ausgabe des Siemens-Selbsttests an die Schülerinnen und Schüler

Der Siemens-Selbsttest wird in Packungen mit jeweils 20 Tests ausgeliefert. Bitte händigen Sie den Schülerinnen und Schülern jeweils ein Fläschchen mit der Pufferlösung sowie das weitere Material für 10 Tests aus. Im Anhang finden Sie dazu eine „Auspackanleitung“.

### Ausgabe des Roche Covid-19-Antigen-Selbsttests an die Schülerinnen und Schüler

In den Packungen der Firma Roche befindet sich jeweils das Material für 25 Tests. Anders als beim Test von Siemens befindet sich die Pufferlösung bereits in den Teströhrchen. Die Tests könnten deshalb auch einzeln verteilt werden. Achtung: Die enthaltenen Teststäbchen sind jedoch nicht für den Selbsttest vorgesehen. Separat erhalten Sie deshalb die zugelassenen Teststäbchen für den Selbsttest. Bitte tauschen Sie die in den Packungen befindlichen Stäbchen gegen die separat gelieferten Stäbchen aus. Auch hierzu finden Sie im Anhang eine kurze Anleitung.

### Hotline für Schulleitungen

Für eine zügige Verteilung der Selbsttests hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie die Aufgabe von der Senatsverwaltung für Gesundheit übernommen. Als direkter Draht ist für Sie ab Freitag

(19.03.2021) unter der Telefonnummer (030) 90227 5500 eine Hotline der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in der Zeit von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr geschaltet. Diese Hotline ist ausschließlich für die Schulleitungen bzw. für die von den Schulleitungen mit der Ausgabeorganisation der Selbsttests beauftragten Kolleginnen und Kollegen reserviert.

### **Informationsmaterial zu den Selbsttests**

Wie bereits im letzten Schreiben angekündigt, sind auf der neu eingerichteten Webseite [www.einfach-testen.berlin](http://www.einfach-testen.berlin) die zentralen Informationsmaterialien zusammengefasst. Insbesondere:

- Erklärvideos zur Anwendung der Selbsttests von Siemens und Roche. Auch direkt über YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=Lr6PFWSlxzg> bzw. <https://www.youtube.com/watch?v=AeV6trmiEo0>
- Grafische Kurzanleitung zu den einzelnen Selbsttests (einfache Anleitung in 11 Sprachen)
- Beipackzettel der Hersteller
- Grafische Auspack- und Verteilanleitung für die einzelnen Selbsttests
- Karte mit den zentralen PCR-Nachteststellen
- Grafik Teststrategie
- Grafik Corona Sicherheitsmaßnahmen
- FAQs zur Teststrategie

Aufgrund bestehender Lieferengpässe und den sich daraus ergebenden Herausforderungen bezüglich der Distribution konnten in der ersten Lieferung nicht alle Schulen in ausreichendem Umfang mit Selbsttests versorgt werden. Die Auslieferung einer zweiten Charge hat bereits begonnen und weitere Chargen werden folgen, so dass dann möglichst alle Schülerinnen und Schüler, die sich in Präsenz an Ihren Schulen befinden, zumindest bis zu den Osterferien zwei wöchentliche Selbsttestungen durchführen können.

Wir wissen, dass der zeitweise Einsatz von drei verschiedenen Selbsttests für Sie als Schulleitung einen erhöhten Aufwand bedeutet, aber aus Gründen der Verfügbarkeit und fehlenden Zulassung des Tests von nal von minden als Selbsttest, sah sich die Gesundheitsverwaltung dazu gezwungen, verschiedene Tests zu bestellen. Die flächendeckende Testung von Schulpersonal und Schülerschaft ist ein zentrales Element der Pandemieeindämmung in unseren Schulen, deshalb bitten wir Sie, diese auch weiterhin engagiert zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen



Christian Blume  
Leiter der Abteilung I



Thomas Duveneck  
Leiter der Abteilung II



Mirko Salchow  
Leiter der Abteilung IV (komm.)

# SELBSTTESTKITS EINFACH (AUS-)PACKEN


CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test Hersteller: Siemens Healthineers

Senatsverwaltung  
für Bildung, Jugend  
und Familie


BERLIN



1

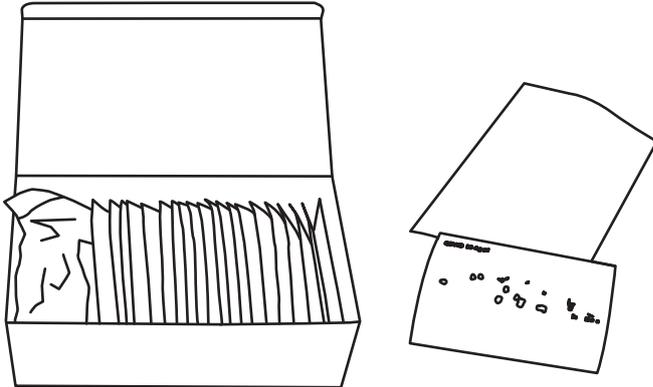


2

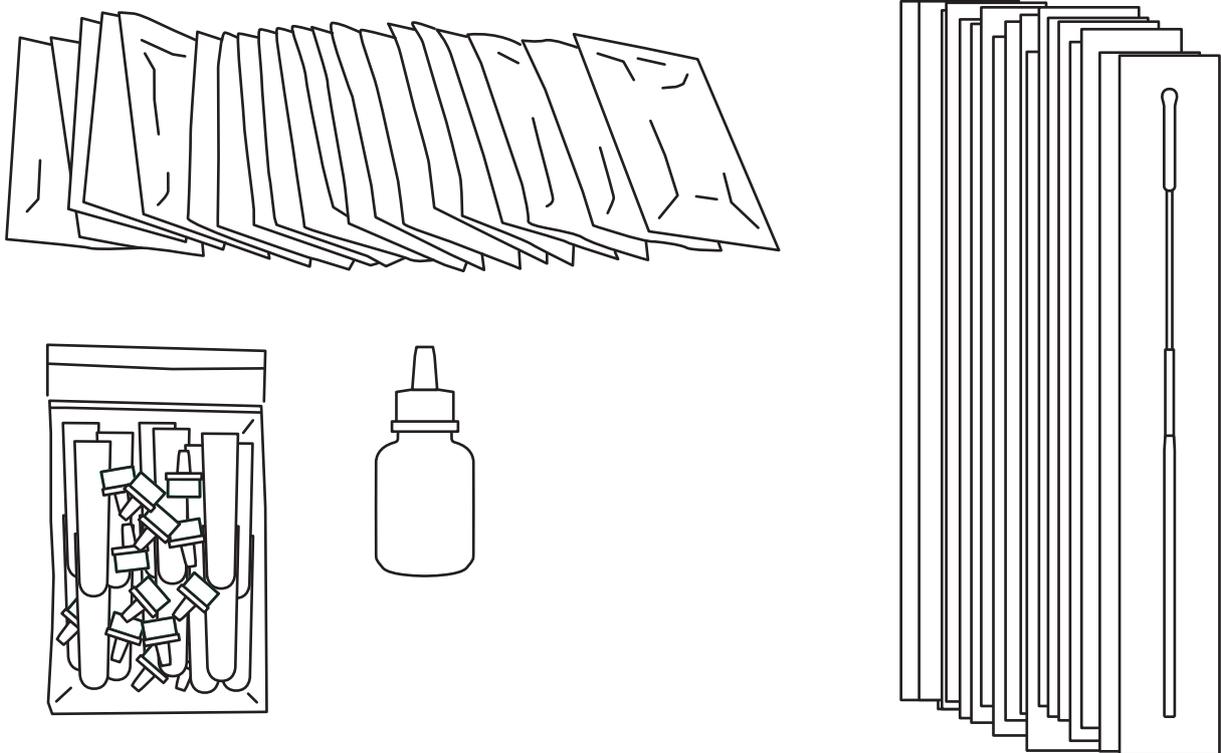

3

Mindestausgabe pro Person

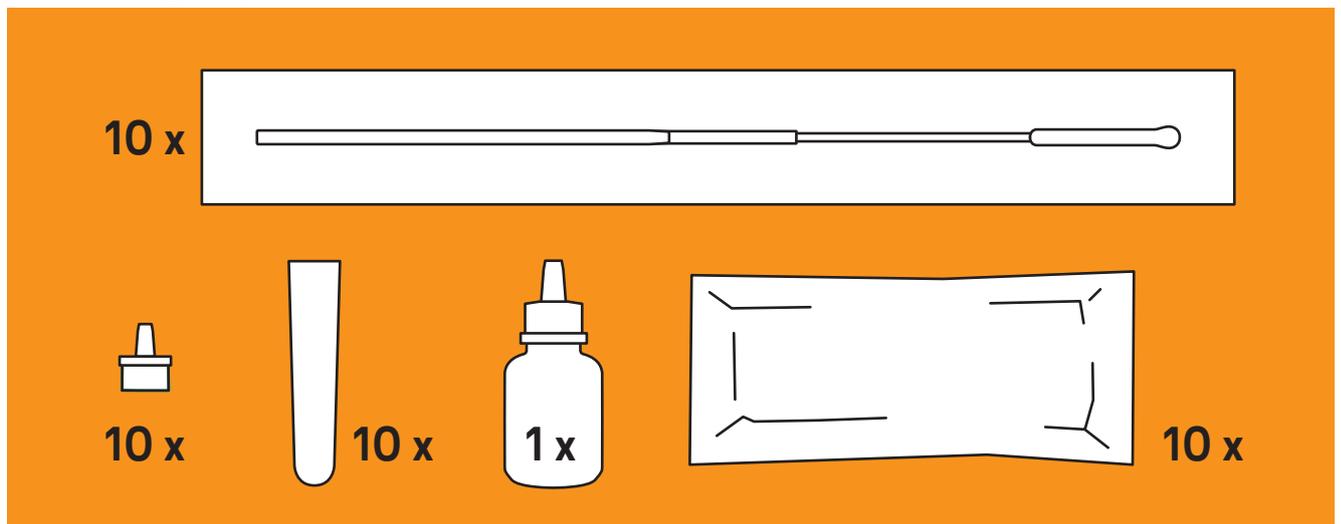

# SELBSTTESTKITS EINFACH (AUS-)PACKEN


SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Hersteller: Roche

Senatsverwaltung  
für Bildung, Jugend  
und Familie

BERLIN




1

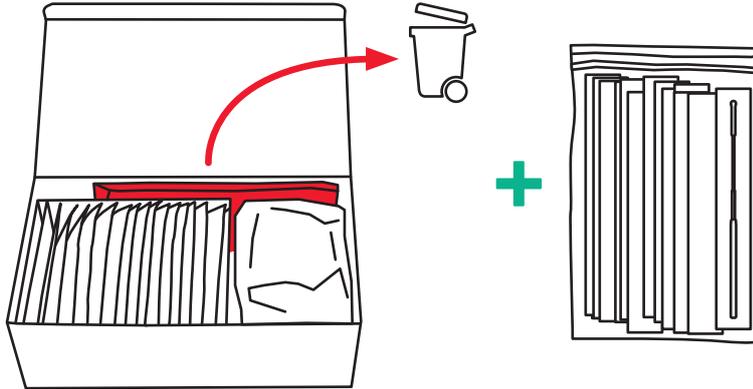

Die beiliegenden Abstrichtupfer  
nicht verwenden, sondern im  
Hausmüll entsorgen

Zur Probenentnahme den separat  
erhältlichen Abstrichtupfer  
(Marke: Nasal Swabs, Mat.-Nr.  
09 421 777 001) verwenden

2

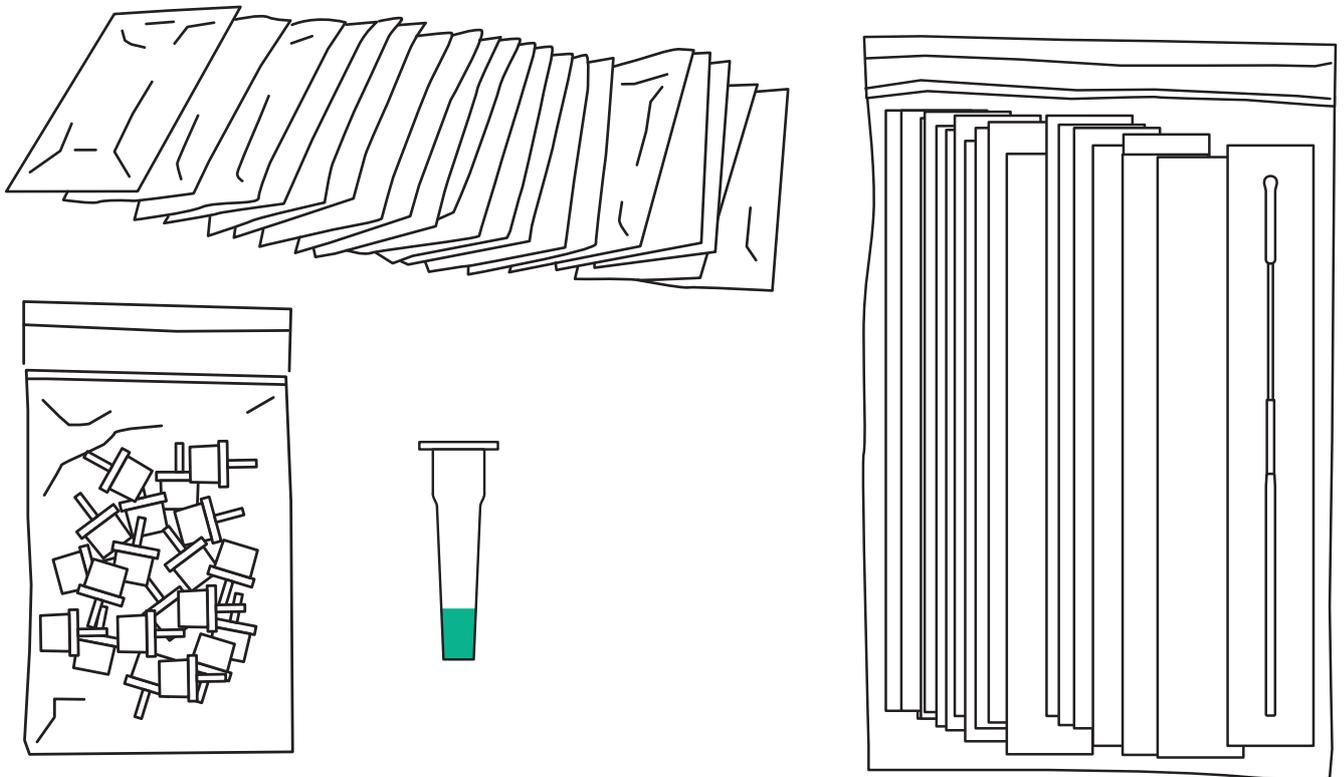

3

Mindestausgabe pro Person

